
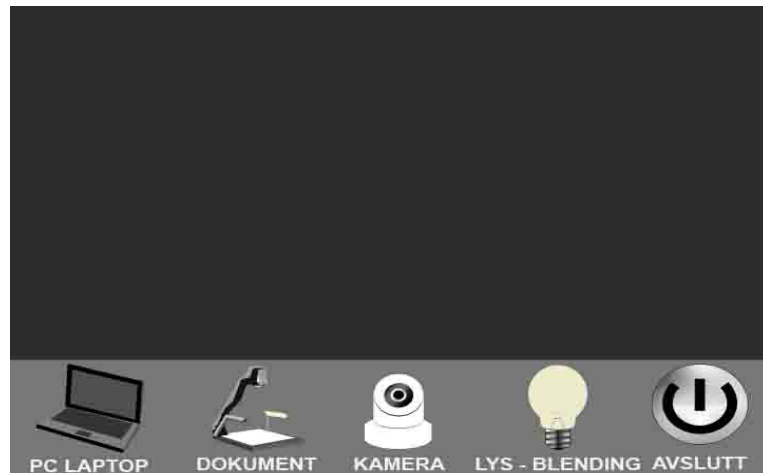


Auditorium I

GV01205

2. Hovedvindu

1. Trykk "Start"

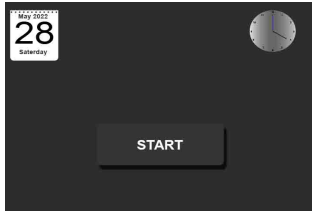

Denne velge vestre skjerm fra Fast-PCen


Side 2

Denne velge vestre skjerm fra Fast-PCen

Styrer lyden opp og ned

Dette kilde velger alt som er koblet til HDMI kablen nede på bordet.

Denne knappen skrur av og på mikrofonen både til rommet og til Lyd-opptak på PCen

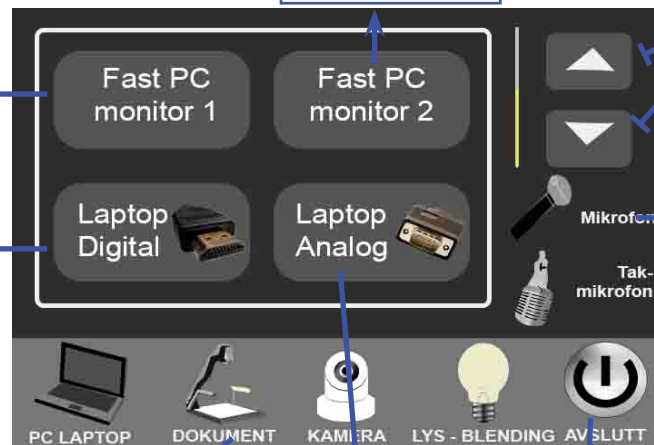

HDMI inngang som ligger på talerstolen

Denne var tilkoblingen for eksterne kilder som brukte VGA

Denne stenger ned systemet etter 30 sekunder hvis du trykker på den.

3. Trådløs mikrofon



Trådløse mikrofoner: Hodemikrofon stås på ved å åpne deksel, på/av bryteren under deksel. Mute knappen på topp av senderen. Håndhold mikrofon, trekkes ut av holderen, slås av/på med rød knapp. Husk å slå av mikrofon etter bruk, og sett mikrofonen tilbake i dokkingstasjonen. Se etter at lampen lyser på dokkingstasjonen.

Antallet sitteplasser: 86,
AV-utstyr: Prosjektor, Mikrofon plassert på toppen av AV-rack, Kritt tavler og styrbart-kamera Fjernkontroll med laser (mottaker i fast-PC. USB-kontakter på kateter. Feil på utstyr skal meldes til IT-seksjonen på telefon +47 (228) 52222 eller E-post: odont-it@odont.uio.no



Auditorium I

GV01205

4. LYS - BLENDING

Side 1

Kjører lerretet manuelt ned

Kjører lerretet manuelt opp

Kjører blendingsgardinene manuelt opp.

Stopper blendingsgardinen på vei opp eller ned

Kjører blendingsgardinene manuelt ned.

Denne stenger ned systemet etter 30 sekunder hvis du trykker på den.

PC LAPTOP DOKUMENT KAMERA LYS - BLENDING AVSLUTT

5. KAMERA

Manuell kontroll over Pan (horisontal) og Tilt (Vertikal) bevegelse kameraet.

Manuell kontroll over zoomen i kamera. "Zoom +" zoomer inn "Zoom -" zoomer ut.

Preset 1, gir et ganske tett bilde på talerstolen på venstre side.

Preset 3, gir et total bilde av katetere og tar også med en del av de første sete radene.

Preset 2, gi et halv nært bilde av foreleser plass fra litt høyre for PC-skjermene og til vestre for talestolen.

Kamera

Zoom +

Zoom -

Preset 1 Preset 2 Preset 3

PC LAPTOP DOKUMENT KAMERA LYS - BLENDING AVSLUTT

Antallet sitteplasser: 86,
AV-utstyr: Prosjektor, Mikrofon plassert på toppen av AV-rack, Kritt tavler og styrbart-kamera Fjernkontroll med laser (mottaker i fast-PC. USB-kontakter på kateter. Feil på utstyr skal meldes til IT-seksjonen på telefon (228)52222 eller E-post: odont-it@odont.uio.no

